



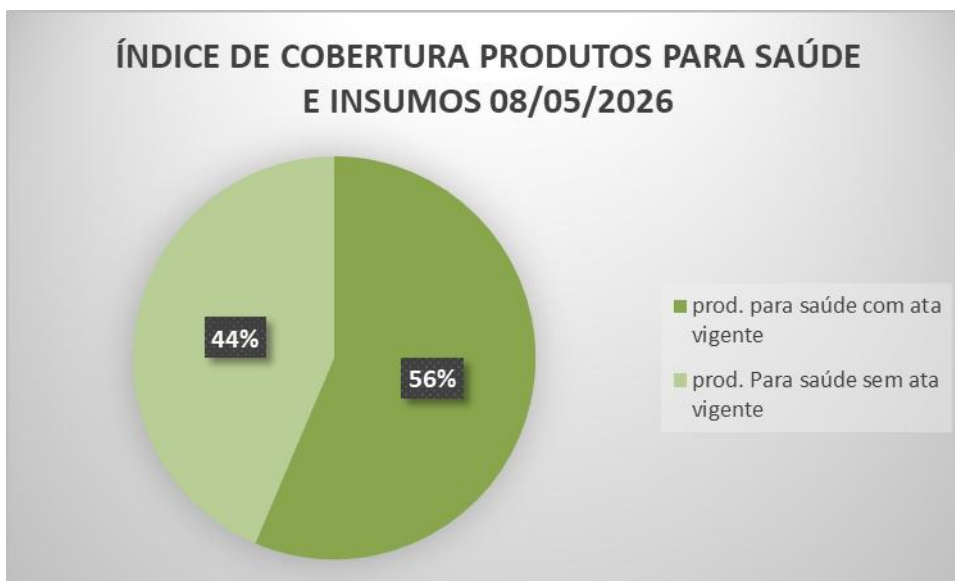

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

**ÍNDICE DE COBERTURA PERP MUNICÍPIOS**  
**08/05/2026**

| ÍNDICE DE COBERTURA PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS |                                  |                |
|---|----------------------------------|----------------|
| PROD. PARA SAÚDE COM ATA VIGENTE                  | PROD. PARA SAÚDE SEM ATA VIGENTE | TOTAL DE ITENS |
| 44  | 34                               | 78             |

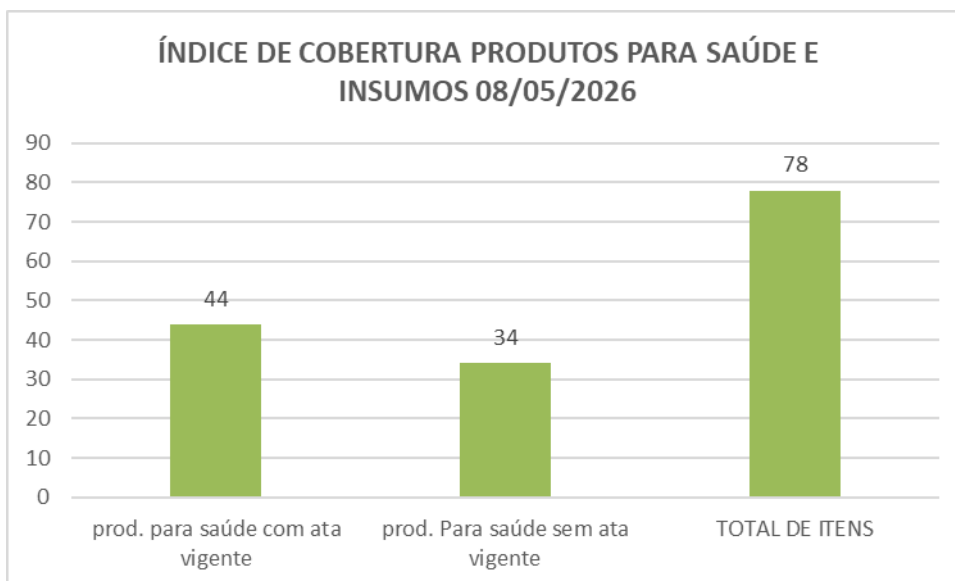



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

| <b>PROD. SAÚDE E INSUMOS SEM ATA VIGENTE</b>       | <b>PROCESSO</b> | <b>STATUS DO PROCESSO</b>     | <b>OBSERVAÇÃO</b>        |
|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| AGULHA 13X4,5                                      | 2025-81MVH      | PARECER TÉCNICO               |                          |
| AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL         | 2025-S151P      | PARECER TÉCNICO               |                          |
| AVENTAL SMS NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 G    | 2025-QL719      | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| CATETER VENOSO PERIFÉRICO 18G                      | 2025-81MVH      | PARECER TÉCNICO               |                          |
| CATETER VENOSO PERIFÉRICO                          | 2025-81MVH      | PARECER TÉCNICO               |                          |
| CATETER VENOSO PERIFÉRICO 22G                      | 2025-81MVH      | PARECER TÉCNICO               |                          |
| CONEXAO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES EM Y 2 VIAS | 2026-6QS6J      | PESQUISA DE PREÇO             | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| EQUIPO MACROGOTAS                                  | 2026-53496      | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| ESCALPE 21   | 2026-9TF59      | AGUARDANDO PREGÃO             |                          |
| MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL                      | 2025-2QNH5      | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| MÁSCARA PFF2, N95                                  | 2025-B2410      | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SERINGA 20ML LUER LOCK                             | 2025-54PLO      | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SERINGA 3ML - LUER LOCK                            | 2024-KZQ22      | EDITAL IMPUGNADO              | PROCESSO NA PGE          |
| SERINGA 3ML - LUER SLIP                            | 2025-54PLO      | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SERINGA 5ML - LUER LOCK                            | 2025-54PLO      | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM C/ DISPOSITIVO     | 2024-KZQ22      | EDITAL IMPUGNADO              | PROCESSO NA PGE          |
| SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM SEM DISPOSITIVO    | 2024-KZQ22      | EDITAL IMPUGNADO              | PROCESSO NA PGE          |
| SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM C/ DISPOSITIVO      | 2024-KZQ22      | EDITAL IMPUGNADO              | PROCESSO NA PGE          |
| SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM SEM DISPOSITIVO     | 2024-KZQ22      | EDITAL IMPUGNADO              | PROCESSO NA PGE          |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 14 - SILICONE 2 VIAS  | 2026-RKSMG      | PESQUISA DE PREÇO             | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 16 3 VIAS - SILICONE  | 2026-6QS6J      | PESQUISA DE PREÇO             | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 22 - SILICONE 2 VIAS  | 2026-RKSMG      | PESQUISA DE PREÇO             | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 12                 | 2025-291Q1      | PREGÃO AGENDADO<br>07/05/2026 | FRACASSADO ANTERIORMENTE |
| SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14                 | 2025-291Q1      | PREGÃO AGENDADO<br>07/05/2026 | FRACASSADO ANTERIORMENTE |



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

|   |            |                               |                                     |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON;<br>TAMANHO: NUMERO 04 (40CM)               | 2026-9TF59 | AGUARDANDO PREGÃO             |                                     |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON;<br>TAMANHO: NUMERO 16                      | 2025-W2QQ2 | PREGÃO AGENDADO<br>11/05/2026 | FRACASSADO<br>ANTERIORMENTE         |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON;<br>TAMANHO: NUMERO 18                      | 2026-9TF59 | AGUARDANDO PREGÃO             |                                     |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON;<br>TAMANHO: NUMERO 20                      | 2026-9TF59 | AGUARDANDO PREGÃO             |                                     |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON;<br>TAMANHO: NUMERO 22                      | 2026-9TF59 | AGUARDANDO PREGÃO             |                                     |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON;<br>TAMANHO: NUMERO 24                      | 2026-9TF59 | AGUARDANDO PREGÃO             |                                     |
| TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA   | 2024-V0ZB7 | PARECER TÉCNICO               |                                     |
| LUVA CIRÚRGICA 7.0  | 2026-THV3B | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | REVOGADO NO<br>PROCESSO<br>ANTERIOR |
| LUVA CIRÚRGICA 7.5  | 2026-THV3B | ELABORAÇÃO DE EDITAL          | REVOGADO NO<br>PROCESSO<br>ANTERIOR |
| ATADURA DE CREPE; 10CM X COMPR<br>APROX 1,80M (REPOUSO) X COMPR APROX<br>4,5M | 2026-HJ125 | ELABORAÇÃO DE TR              | FRACASSADO<br>ANTERIORMENTE         |

**Programa Estadual de Registro de Preços – PERP**  
Núcleo Especial de Programação Técnica  
GEAF/SSAS/SESA