




**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica


**ÍNDICE DE COBERTURA PERP MUNICÍPIOS**  
**09/01/2026**

ÍNDICE DE COBERTURA PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS		
PROD. PARA SAÚDE COM ATA VIGENTE	PROD. PARA SAÚDE SEM ATA VIGENTE	TOTAL DE ITENS
31	47	78

**ÍNDICE DE COBERTURA PERP PRODUTOS P/  
SAÚDE E INSUMOS 09/01/2026**

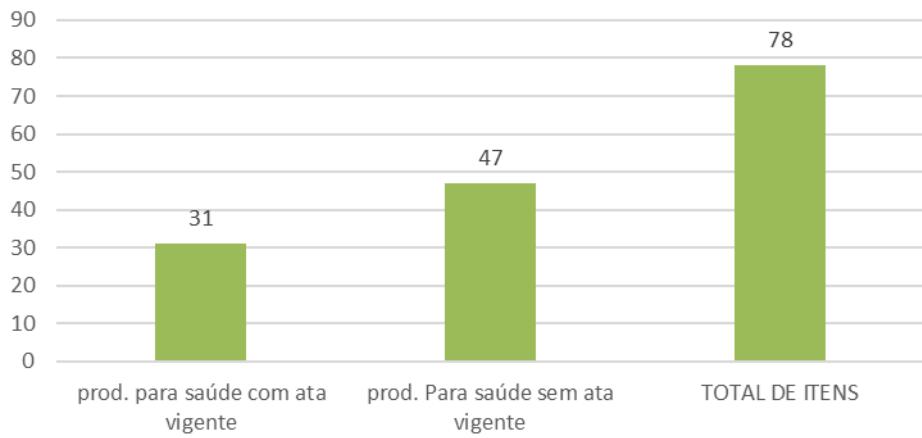

**ÍNDICE DE COBERTURA PERP PRODUTOS P/  
SAÚDE E INSUMOS 09/01/2026**

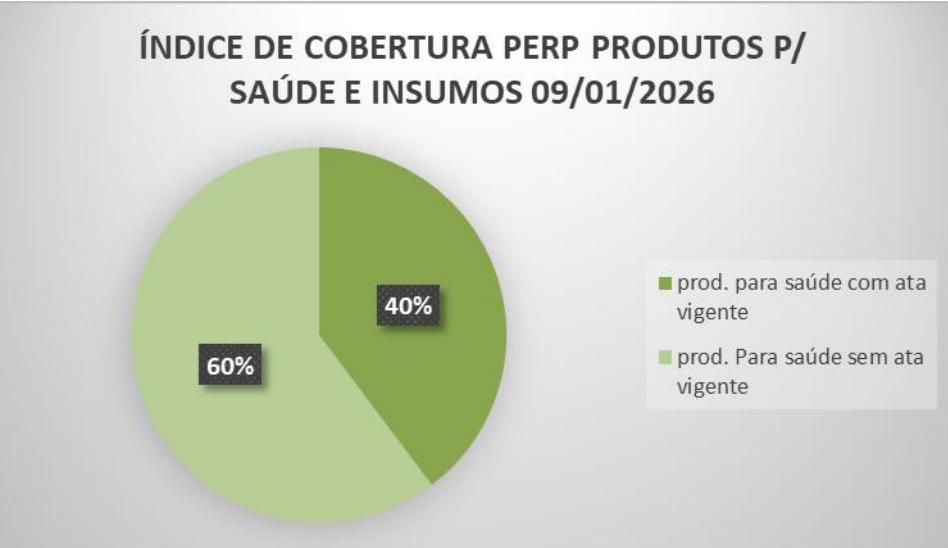



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

PROD. SAÚDE E INSUMOS SEM ATA VIGENTE	PROCESSO	STATUS DO PROCESSO	OBSERVAÇÃO
ÁLCOOL 70 % 1000ML SOLUÇÃO SANEANTE	2025-56LSW	ELABORAÇÃO DE ATA	
AVENTAL SMS NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 G	2025-QL719	REPETINDO PREGÃO	
CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO 16 G	2025-N60GQ	PARECER TÉCNICO	
CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO 24 G	2025-N60GQ	PARECER TÉCNICO	
COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45X50CM	2025-JB1MQ	PARECER TÉCNICO	
EQUIPO MACROGOTAS	2025-BPHGH	PARECER TÉCNICO	
ESCALPE 21	2025-84VKV	FRACASSADO	
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	2025-713NB	PARECER TÉCNICO	
FILME TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL TIPO ROLO	2025-713NB	PARECER TÉCNICO	
LUVA DE PROCEDIMENTO G	2025-NK6MV	PARECER TÉCNICO	
LUVA DE PROCEDIMENTO P	2025-NK6MV	PARECER TÉCNICO	
MÁSCARA PFF2, N95	2025-B2410	PARECER TÉCNICO	
SERINGA 20ML LUER LOCK	2025-54PL0	REPETINDO PREGÃO	
SERINGA 3ML - LUER LOCK	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA 3ML - LUER SLIP	2025-54PL0	REPETINDO PREGÃO	
SERINGA 5ML - LUER LOCK	2025-54PL0	REPETINDO PREGÃO	
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA ESTÉRIL P/ IRRIGAÇÃO DE FERIDAS	2025-84VKV	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 12 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 14 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 16 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 18- SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 20 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 22 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 24 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 12	2025-291Q1	REPETINDO PREGÃO	
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14	2025-291Q1	REPETINDO PREGÃO	
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 04 (40CM)	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 06	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 08	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 10	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 14	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 16	2025-W2QQ2	ELABORAÇÃO TR	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 18	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 20	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 22	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 24	2025-0D22F	PARECER TÉCNICO	PREGÃO REALIZADO EM 03/11/2025
DIRA REAGENTE PARA GLICEMIA (Reagente Para Diagnóstico Clínico 5) 244842	2024-V0ZB7	PARECER TÉCNICO	
LUVA CIRÚRGICA 7.0	2025-69HCJ	ITEM REVOGADO NO PREGÃO	
LUVA CIRÚRGICA 7.5	2025-69HCJ	ITEM REVOGADO NO PREGÃO	
LUVA CIRÚRGICA 8.0	2025-69HCJ	PARECER TÉCNICO	
ATADURA DE CREPE; 10CM X COMPR APROX 1,80M (REPOUSO) X COMPR APROX 4,5M	2025-L9ZMK	PARECER TÉCNICO	
CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE CAPACIDADE: 13 L	2025-L9ZMK	PARECER TÉCNICO	