



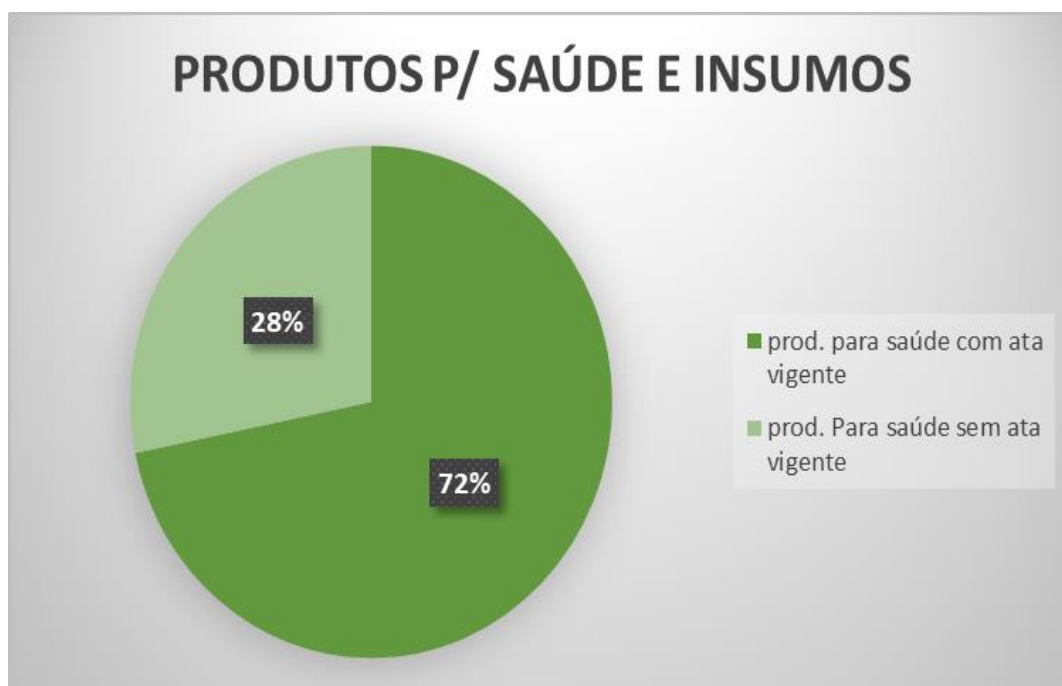

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

ÍNDICE DE COBERTURA PERP MUNICÍPIOS

ÍNDICE DE COBERTURA PRODUTOS PARA SAÚDE		
Prod. para saúde com ata vigente	Prod. Para saúde sem ata vigente	TOTAL DE ITENS
56	22	78

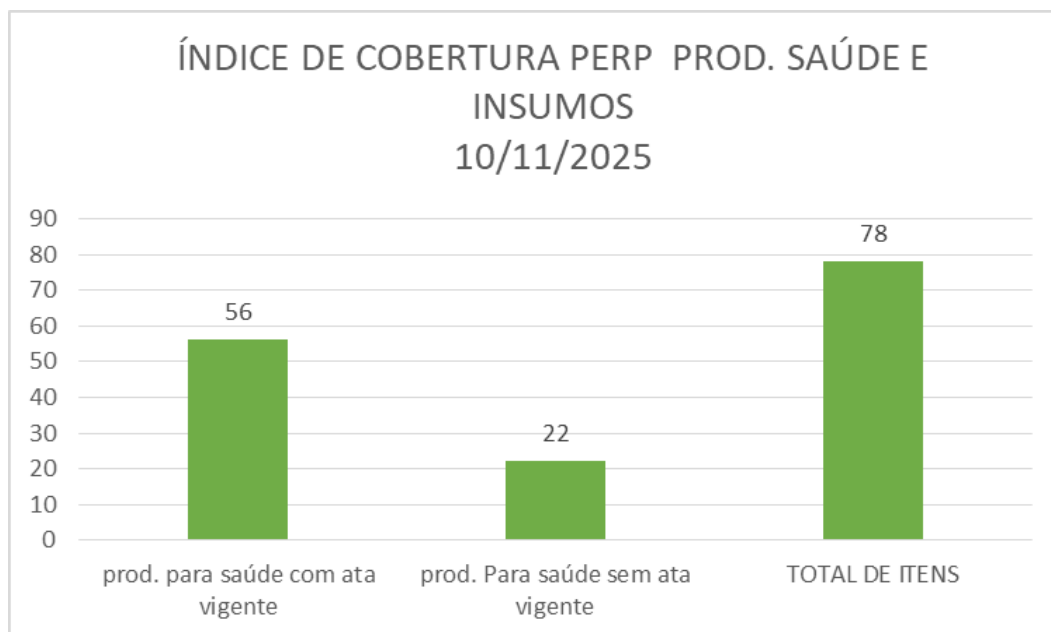



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

PROD. P/ SAÚDE SEM ATA VIGENTE	PROCESSO	STATUS DO PROCESSO	OBSERVAÇÃO
ÁLCOOL 70 % 1000ML SOLUÇÃO SANEANTE	2025-56LSW	PARECER TÉCNICO	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 30/08/2025
ATADURA DE CREPE; 10CM X 4,5M	2025-L9ZMK	PARECER TÉCNICO	
AVENTAL SMS NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 G	2025-QL719	PARECER TÉCNICO	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 15/10/2025
CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE CAPACIDADE: 13 L	2025-L9ZMK	PARECER TÉCNICO	
COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45X50CM	2025-JB1MQ	PREGÃO AGENDADO 01/12/2025	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 29/08/2025
EQUIPO MACROGOTAS	2025-BPHGH	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	2025-713NB	PARECER TÉCNICO	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 23/10/2025
FILME TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL TIPO ROLO	2025-713NB	PARECER TÉCNICO	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 23/10/2025
MÁSCARA PFF2, N95	2025-B2410	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA 20ML LUER LOCK	2025-54PL0	PARECER TÉCNICO	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 03/10/2025
SERINGA 3ML - LUER LOCK	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA 3ML - LUER SLIP	2025-54PL0	PARECER TÉCNICO	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 03/10/2025
SERINGA 5ML - LUER LOCK	2025-54PL0	PARECER TÉCNICO	FIM DA VIGÊNCIA DA ÚLTIMA ATA 03/10/2025
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	ELABORAÇÃO DE EDITAL	
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 12	2025-291Q1	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14	2025-291Q1	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA	2024-V0ZB7	PARECER TÉCNICO	AGUARDANDO ALGUM MUNICÍPIO SE DISPONIBILIZAR PARA ANALISAR AMOSTRA
LUVA DE PROCEDIMENTO G	2025-NK6MV	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
LUVA DE PROCEDIMENTO P	2025-NK6MV	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO