



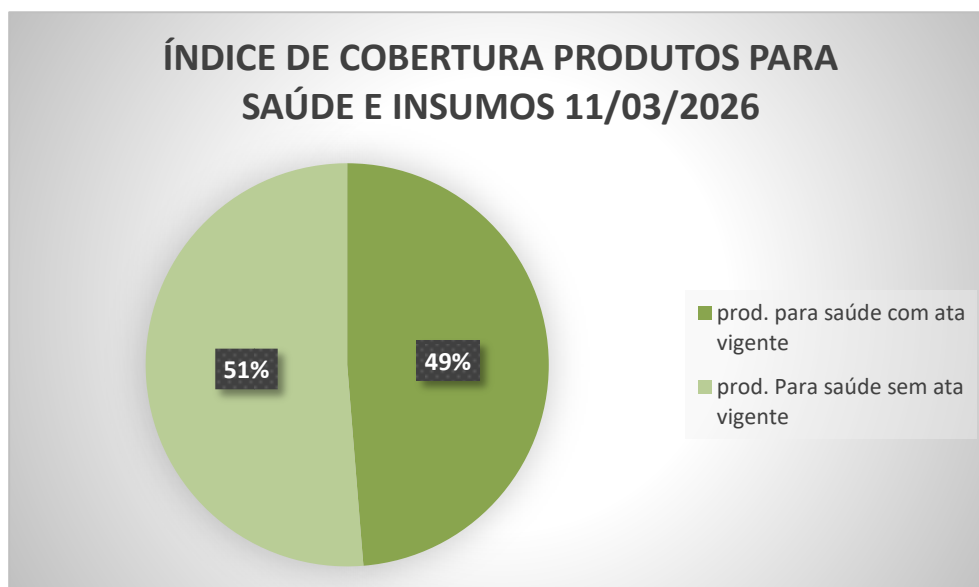

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

**ÍNDICE DE COBERTURA PERP MUNICÍPIOS**  
**11/03/2026**

| ÍNDICE DE COBERTURA PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS |                                  |                |
|---|----------------------------------|----------------|
| prod. para saúde com ata vigente                  | prod. Para saúde sem ata vigente | TOTAL DE ITENS |
| 38  | 40                               | 78             |

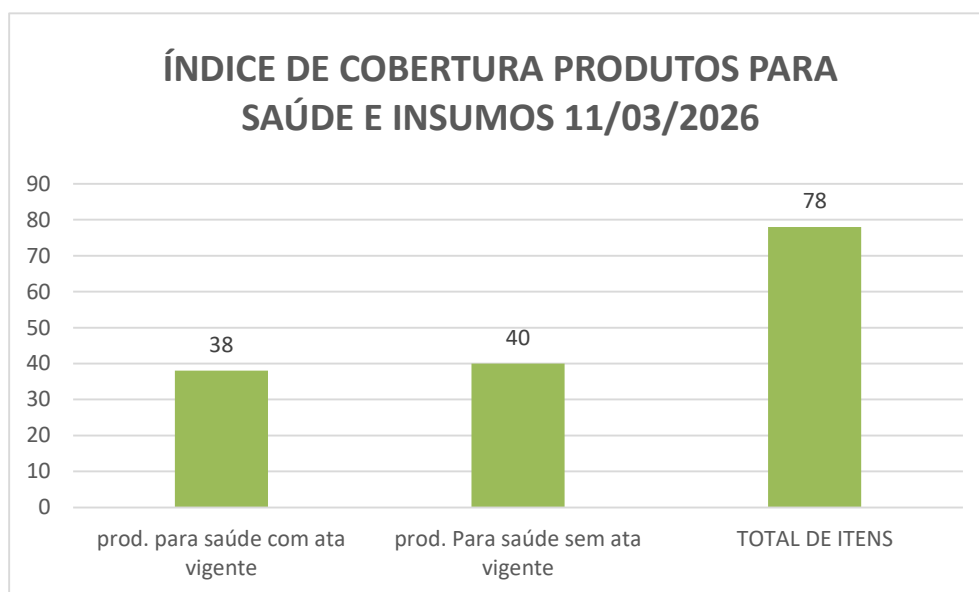



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

| <b>PROD. SAÚDE E INSUMOS SEM ATA VIGENTE</b>                | <b>PROCESSO</b> | <b>STATUS DO PROCESSO</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>            |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| AVENTAL SMS NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 G             | 2025-QL719      | ELABORAÇÃO DE EDITAL      | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO 16 G                  | 2025-N60GQ      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO 24 G                  | 2025-N60GQ      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45X50CM | 2025-JB1MQ      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| CONEXAO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES EM Y 2 VIAS          | 2025-DSL2J      | FRACASSADO                |                              |
| EQUIPO MACROGOTAS   | 2025-BPHGH      | FRACASSADO                |                              |
| ESCALPE 21  | 2026-9TF59      | PESQUISA DE PREÇO         | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| LUVA DE PROCEDIMENTO G                                      | 2025-NK6MV      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| LUVA DE PROCEDIMENTO P                                      | 2025-NK6MV      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| MÁSCARA PFF2, N95   | 2025-B2410      | PARECER TÉCNICO           | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SERINGA 20ML LUER LOCK                                      | 2025-54PLO      | ELABORAÇÃO DE EDITAL      | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SERINGA 3ML - LUER LOCK                                     | 2024-KZQ22      | PREGÃO REVOGADO           |                              |
| SERINGA 3ML - LUER SLIP                                     | 2025-54PLO      | ELABORAÇÃO DE EDITAL      | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SERINGA 5ML - LUER LOCK                                     | 2025-54PLO      | ELABORAÇÃO DE EDITAL      | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM C/ DISPOSITIVO              | 2024-KZQ22      | PREGÃO REVOGADO           |                              |
| SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM SEM DISPOSITIVO             | 2024-KZQ22      | PREGÃO REVOGADO           |                              |
| SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM C/ DISPOSITIVO               | 2024-KZQ22      | PREGÃO REVOGADO           |                              |
| SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM SEM DISPOSITIVO              | 2024-KZQ22      | PREGÃO REVOGADO           |                              |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 12 - SILICONE 2 VIAS           | 2025-TQKD5      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 14 - SILICONE 2 VIAS           | 2025-TQKD5      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 16 3 VIAS - SILICONE           | 2025-C18Q2      | FRACASSADO                |                              |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 16 - SILICONE 2 VIAS           | 2025-TQKD5      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 18- SILICONE 2 VIAS            | 2025-TQKD5      | PARECER TÉCNICO           |                              |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 20 - SILICONE 2 VIAS           | 2025-TQKD5      | PARECER TÉCNICO           |                              |



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
*Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica*

|  |            |                      |                              |
|--|------------|----------------------|------------------------------|
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 22 - SILICONE 2 VIAS                        | 2025-TQKD5 | PARECER TÉCNICO      |                              |
| SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 24 - SILICONE 2 VIAS                        | 2025-TQKD5 | PARECER TÉCNICO      |                              |
| SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 12                                       | 2025-291Q1 | ELABORAÇÃO DE EDITAL | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14                                       | 2025-291Q1 | ELABORAÇÃO DE EDITAL | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 04 (40CM)             | 2026-9TF59 | PESQUISA DE PREÇO    | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 16                    | 2025-W2QQ2 | PESQUISA DE PREÇO    | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 18                    | 2026-9TF59 | PESQUISA DE PREÇO    | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 20                    | 2026-9TF59 | PESQUISA DE PREÇO    | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 22                    | 2026-9TF59 | PESQUISA DE PREÇO    | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 24                    | 2026-9TF59 | PESQUISA DE PREÇO    | PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO |
| TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA (Reagente Para Diagnóstico Clínico 5) 244842 | 2024-V0ZB7 | PARECER TÉCNICO      |                              |
| LUVA CIRÚRGICA 7.0   | 2025-69HCJ | PARECER TÉCNICO      |                              |
| LUVA CIRÚRGICA 7.5   | 2025-69HCJ | PARECER TÉCNICO      |                              |
| LUVA CIRÚRGICA 8.0   | 2025-69HCJ | PARECER TÉCNICO      |                              |
| ATADURA DE CREPE; 10CM X COMPR APROX 1,80M (REPOUSO) X COMPR APROX 4,5M  | 2025-L9ZMK | PARECER TÉCNICO      |                              |
| CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE CAPACIDADE: 13 L                     | 2025-L9ZMK | PARECER TÉCNICO      |                              |

**Programa Estadual de Registro de Preços – PERP**

Núcleo Especial de Programação Técnica

GEAF/SSAS/SESA