



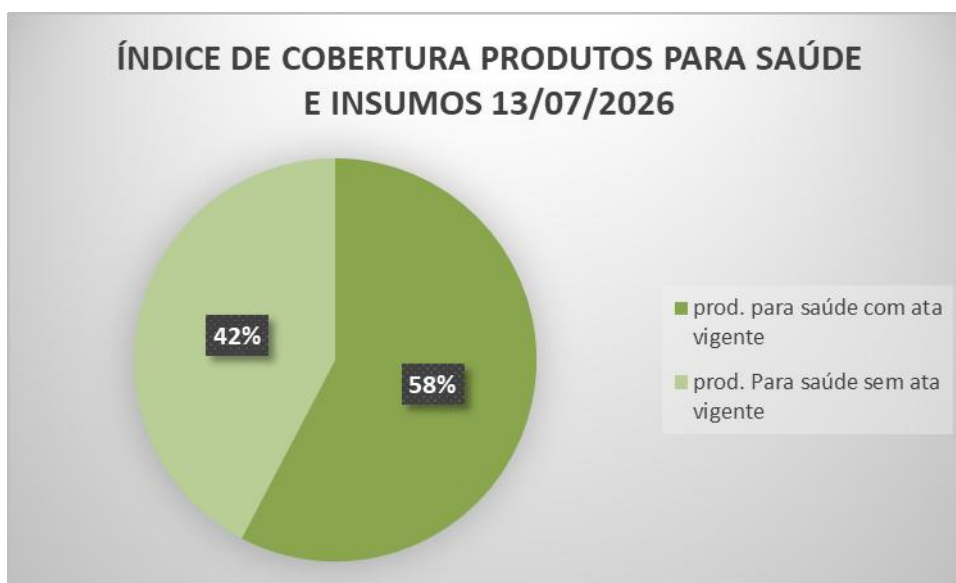

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

ÍNDICE DE COBERTURA PERP MUNICÍPIOS
PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS 13/07/2026

ÍNDICE DE COBERTURA PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS		
prod. para saúde com ata vigente	prod. Para saúde sem ata vigente	TOTAL DE ITENS
45	33	78

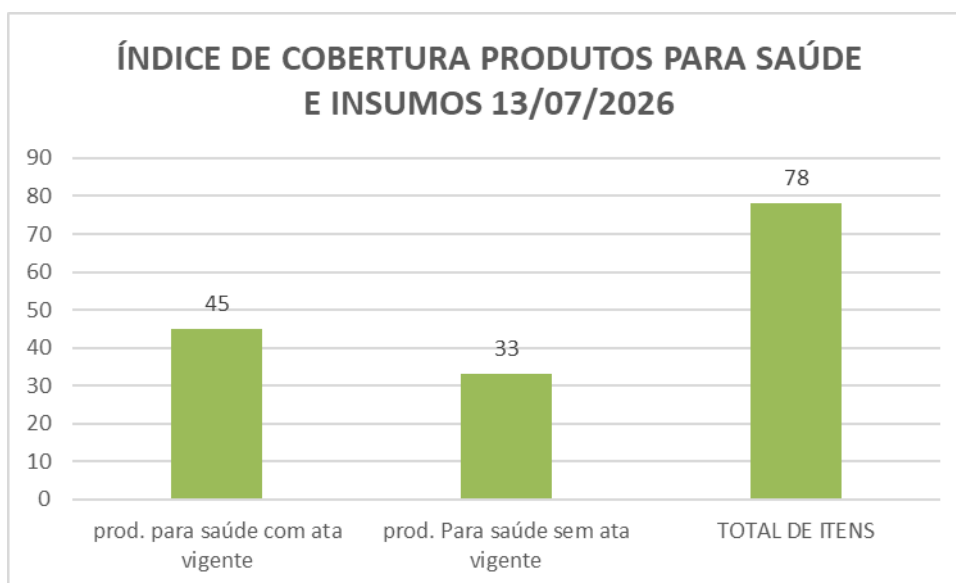



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

MEDICAMENTOS SEM ATA VIGENTE	PROCESSO	STATUS DO PROCESSO	OBSERVAÇÃO
AGULHA 13X4,5	2025-81MVH	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL	2025-S151P	FRACASSADO REPETINDO PREGÃO	
AVENTAL SMS NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 G	2025-QL719	FRACASSADO REPETINDO PREGÃO	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
CATETER VENOSO PERIFÉRICO 18G	2025-81MVH	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	
CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G	2025-81MVH	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	
CATETER VENOSO PERIFÉRICO 22G	2025-81MVH	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	
CONEXAO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES EM Y 2 VIAS	2026-6QS6J	PREGÃO AGENDADO 29/07/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
EQUIPO MACROGOTAS	2026-53496	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
ESCALPE 21	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	2025-2QNH5	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
MÁSCARA PFF2, N95	2025-B2410	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SERINGA 20ML LUER LOCK	2025-54PL0	PREGÃO AGENDADO 25/08/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SERINGA 3ML - LUER LOCK	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA 3ML - LUER SLIP	2025-54PL0	PREGÃO AGENDADO 25/08/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SERINGA 5ML - LUER LOCK	2025-54PL0	PREGÃO AGENDADO 25/08/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 14 -SILICONE 2 VIAS	2026-RKSMG	PREGÃO AGENDADO 24/08/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 16 3 VIAS - SILICONE	2026-6QS6J	PREGÃO AGENDADO 29/07/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 22 -SILICONE 2 VIAS	2026-RKSMG	PREGÃO AGENDADO 24/08/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 12	2025-291Q1	PREGÃO AGENDADO 25/08/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14	2025-291Q1	PREGÃO AGENDADO 25/08/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 04 (40CM)	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 18	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 20	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 22	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 24	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR
TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA	2024-V0ZB7	FRACASSADO	
LUVA CIRÚRGICA 7.0	2026-THV3B	PREGÃO AGENDADO 10/08/2026	REVOGADO NO PROCESSO ANTERIOR
LUVA CIRÚRGICA 7.5	2026-THV3B	PREGÃO AGENDADO 10/08/2026	REVOGADO NO PROCESSO ANTERIOR
ATADURA DE CREPE; 10CM X COMPR APROX 1,80M (REPOUSO) X COMPR APROX 4,5M	2026-HJ125	PREGÃO AGENDADO 30/07/2026	FRACASSADO NO PROCESSO ANTERIOR

Programa Estadual de Registro de Preços – PERP
Núcleo Especial de Programação Técnica
GEAF/SSAS/SESA