





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

ÍNDICE DE COBERTURA PERP MUNICÍPIOS

18/03/2026

ÍNDICE DE COBERTURA PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS		
prod. para saúde com ata vigente	prod. Para saúde sem ata vigente	TOTAL DE ITENS
38	40	78

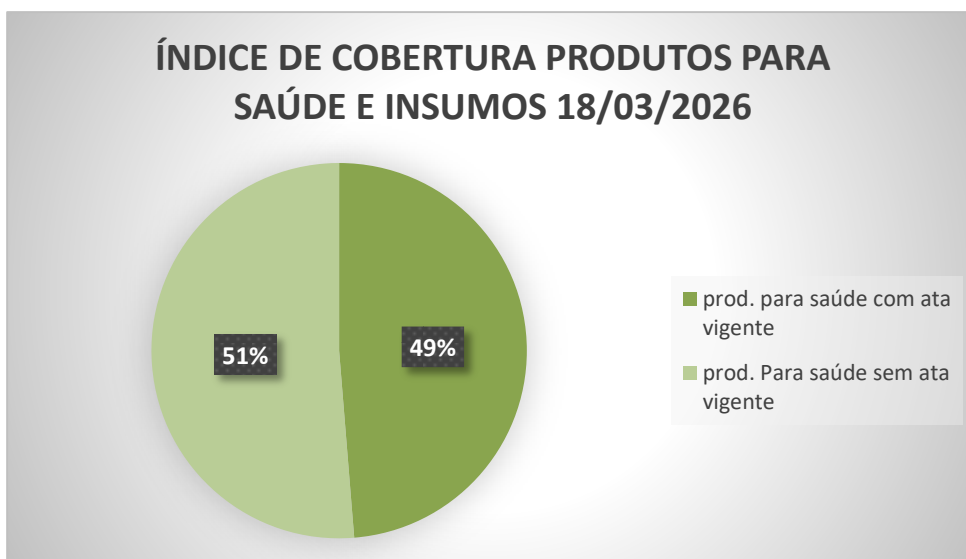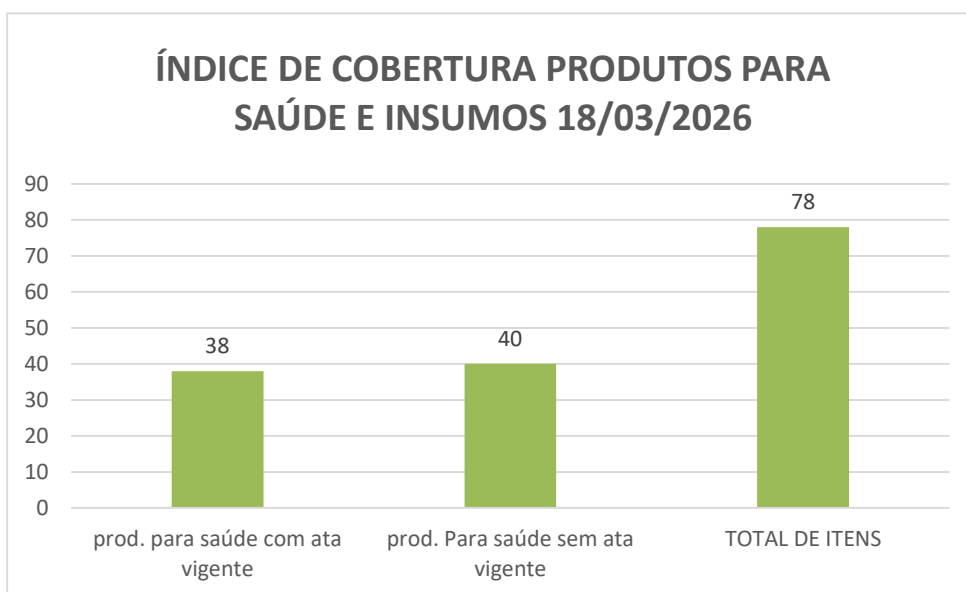



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

PROD. SAÚDE E INSUMOS SEM ATA VIGENTE	PROCESSO	STATUS DO PROCESSO	OBSERVAÇÃO
AVENTAL SMS NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 G	2025-QL719	ELABORAÇÃO DE EDITAL	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO 16 G	2025-N60GQ	PARECER TÉCNICO	
CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO 24 G	2025-N60GQ	PARECER TÉCNICO	
COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45X50CM	2025-JB1MQ	PARECER TÉCNICO	
CONEXAO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES EM Y 2 VIAS	2026-6QS6J	ELABORAÇÃO TR	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
EQUIPO MACROGOTAS	2025-BPHGH	FRACASSADO	
ESCALPE 21	2026-9TF59	PESQUISA DE PREÇO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
LUVA DE PROCEDIMENTO G	2025-NK6MV	HOMOLOGAÇÃO	
LUVA DE PROCEDIMENTO P	2025-NK6MV	HOMOLOGAÇÃO	
MÁSCARA PFF2, N95	2025-B2410	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA 20ML LUER LOCK	2025-54PL0	PREGÃO AGENDADO 08/04/2026	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA 3ML - LUER LOCK	2024-KZQ22	PREGÃO REVOGADO	
SERINGA 3ML - LUER SLIP	2025-54PL0	PREGÃO AGENDADO 08/04/2026	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA 5ML - LUER LOCK	2025-54PL0	PREGÃO AGENDADO 08/04/2026	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	PREGÃO REVOGADO	
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	PREGÃO REVOGADO	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	PREGÃO REVOGADO	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	PREGÃO REVOGADO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 12 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 14 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 16 3 VIAS - SILICONE	2026-6QS6J	ELABORAÇÃO TR	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 16 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 18- SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 20 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 22 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 24 - SILICONE 2 VIAS	2025-TQKD5	PARECER TÉCNICO	
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 12	2025-291Q1	ELABORAÇÃO DE EDITAL	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14	2025-291Q1	ELABORAÇÃO DE EDITAL	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 04 (40CM)	2026-9TF59	PESQUISA DE PREÇO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 16	2025-W2QQ2	PESQUISA DE PREÇO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 18	2026-9TF59	PESQUISA DE PREÇO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 20	2026-9TF59	PESQUISA DE PREÇO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 22	2026-9TF59	PESQUISA DE PREÇO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 24	2026-9TF59	PESQUISA DE PREÇO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA (Reagente Para Diagnóstico Clínico 5) 244842	2024-V0ZB7	PARECER TÉCNICO	
LUVA CIRÚRGICA 7.0	2026-THV3B	ELABORAÇÃO TR	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
LUVA CIRÚRGICA 7.5	2026-THV3B	ELABORAÇÃO TR	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
LUVA CIRÚRGICA 8.0	2025-69HCJ	HOMOLOGAÇÃO	
ATADURA DE CREPE; 10CM X COMPR APROX 1,80M (REPOUSO) X COMPR APROX 4,5M	2025-L9ZMK	PARECER TÉCNICO	
CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE CAPACIDADE: 13 L	2025-L9ZMK	PARECER TÉCNICO	

Programa Estadual de Registro de Preços – PERP
Núcleo Especial de Programação Técnica
GEAF/SSAS/SESA