



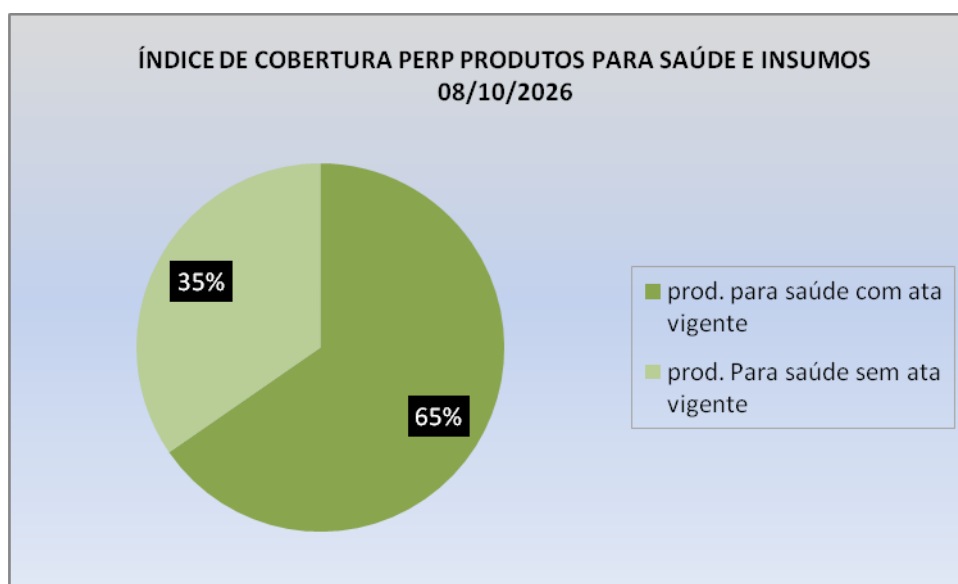

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

ÍNDICE DE COBERTURA PERP MUNICÍPIOS
PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS 08/10/2026

ÍNDICE DE COBERTURA PRODUTOS PARA SAÚDE E INSUMOS		
PROD. PARA SAÚDE COM ATA VIGENTE	PROD. PARA SAÚDE SEM ATA VIGENTE	TOTAL DE ITENS
51	27	78

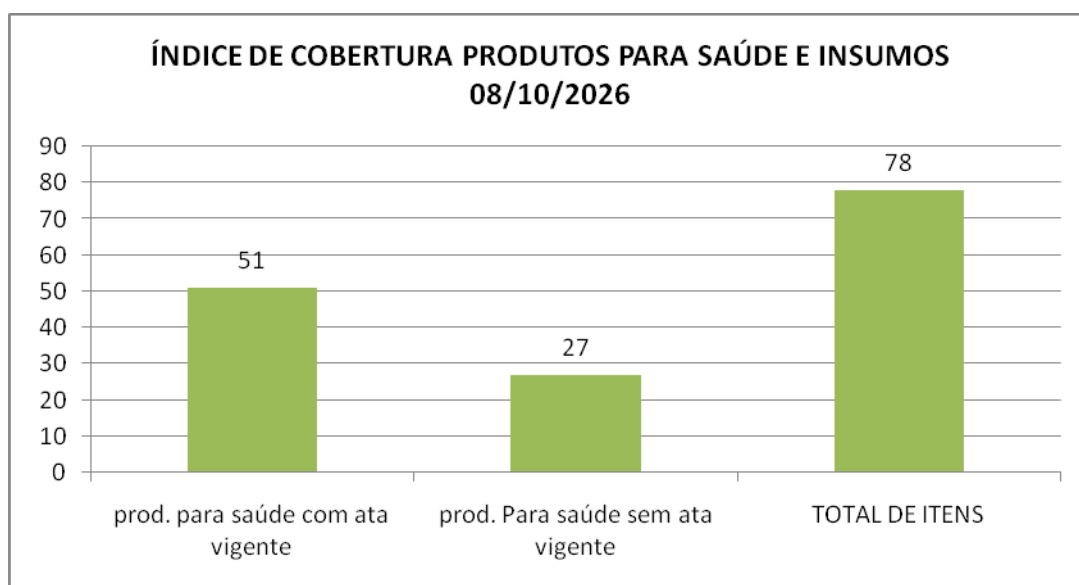



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

PROD SAUDE E INSUMOS SEM ATA VIGENTE	PROCESSO	STATUS DO PROCESSO	OBSERVAÇÃO
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL	2025-S151P	FRACASSADO	
AVENTAL SMS NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 G	2025-QL719	PREGÃO AGENDADO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
ESCALPE 21	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	2025-2QNH5	PREGÃO AGENDADO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
MÁSCARA PFF2, N95	2025-B2410	ELABORAÇÃO DE EDITAL	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA 20ML LUER LOCK	2025-54PL0	ELABORAÇÃO DE EDITAL	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA 3ML - LUER LOCK	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA 3ML - LUER SLIP	2025-54PL0	ELABORAÇÃO DE EDITAL	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA 5ML - LUER LOCK	2025-54PL0	ELABORAÇÃO DE EDITAL	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA DE INSULINA 6 X 0,25 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM C/ DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SERINGA DE INSULINA 8X 0,30 MM SEM DISPOSITIVO	2024-KZQ22	FRACASSADO	
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 14 - SILICONE 2 VIAS	2026-RKSMG	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA FOLEY; TAMANHO: NUMERO 22 - SILICONE 2 VIAS	2026-RKSMG	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 12	2025-291Q1	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14	2025-291Q1	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 04 (40CM)	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 18	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 20	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 22	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 24	2026-9TF59	PARECER TÉCNICO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO
TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA (Reagente Para Diagnóstico Clínico 5) 244842	2024-V0ZB7	FRACASSADO	
LUVA CIRÚRGICA 7.0	2026-THV3B	ELABORAÇÃO DE ATA	REVOGADO NO PROCESSO ANTERIOR
LUVA CIRÚRGICA 7.5	2026-THV3B	ELABORAÇÃO DE ATA	REVOGADO NO PROCESSO ANTERIOR
ATADURA DE CREPE; 10CM X COMPR APROX 1,80M (REPOUSO) X COMPR APROX 4,5M	2026-HJ125	PREGÃO AGENDADO	PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

CAIXA DE PERFUROCORTANTE C/ RISCO QUIMICO CAPACIDADE 13 L (LARANJA)	2026-77CGT	PREGÃO AGENDADO	INCLUSO A PARTIR DA EDIÇÃO XVIII
--	------------	-----------------	----------------------------------

Programa Estadual de Registro de Preços – PERP

Núcleo Especial de Programação Técnica

GEAF/SSAS/SESA